

## 5. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Gli interventi devono sempre essere eseguiti da personale adeguatamente istruito ed a conoscenza del libretto istruzioni.

1. Ogni 6 mesi verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio (robustezza meccanica, serraggio delle viti, pulizia, ecc.).
2. Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: urto, versamento di liquidi, ecc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.
3. Per la pulizia utilizzare un panno inumidito in acqua e detergente non aggressivo.

**Avvertenze:**

— **Non usare disinfettanti alcolici sulla similpelle del lettino.**

La CHINESPORT dispone di un servizio telefonico per l'assistenza tecnica.

In caso di necessità contattare lo **0432/522315**.

In orario diverso da quello commerciale è possibile comunicare a mezzo fax n° 0432-521792.

## 6. RICAMBI

Sono di seguito riportati i riferimenti per la richiesta dei ricambi delle parti sottoposte a maggiore usura.

	CODICE	DESCRIZIONE	n° pezzi per articolo
1	80.23.01.0114	MOLLA A GAS	1
2	85.23.01.0111	RULLO NERO SAGOMATO	2+1

## 6.1 GARANZIA

I riabilitatori CHINESPORT sono coperti da garanzia per il periodo di 12 mesi a partire dalla data registrata sul documento di spedizione. Durante tale periodo la CHINESPORT si impegna alla sostituzione o alla riparazione gratuita di quelle parti che dovessero essere difettose per fabbricazione . Non sono compresi: danni causati da trasporto e/o movimentazione, guasti e/o rotture imputabili ad un errato uso dell'apparecchiatura.

Le riparazioni sono eseguite presso i nostri rivenditori autorizzati e/o nella nostra sede alla quale, pertanto, dovranno essere recapitati gli eventuali resi con spese di trasporto a carico del cliente.

Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di UDINE.

Per rendere operante la garanzia, ed in ogni caso per reclami o assistenza di natura tecnica, contattare direttamente il nostro Responsabile Assistenza Tecnica.

## 7 SPECIFICHE TECNICHE E CONFORMITÀ

## 7.1 SCHEDA TECNICA

Denominazione articolo	Riabilitatore arti
Dimensioni cm (lxpxh)	71x83÷123x85÷125
Peso	Kg 35
Peso massimo ammissibile	Kg 135

## 7.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Denominazione prodotto	<i>Riabilitatore arti a braccio oscillante art.03.4.07465</i> <i>Braccio oscillante per riabilitatore art. 03.4.07466</i>
Tipo di prodotto	<i>Riabilitatore per arti superiori ed inferiori</i>
Classe di appartenenza ( art. 8 del D.Lgs. n.46 del 24/03/1997)	<i>I</i>
<b>L'articolo sopradescritto è conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42.</b>	
CHINESPORT S.p.A. (Rapp.Legale)	



CHINESPORT SPA

Via Croazia, n°2 - 33100 UDINE - ITALY

Tel. 0432 - 522315 - Fax 0432 - 521792



# LIBRETTO D'ISTRUZIONI

RIABILITATORE ARTI A BRACCIO OSCILLANTE	03.4.07465
BRACCIO OSCILLANTE CON PESI	03.4.07466



**PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI COMPLIMENTI !** Avete acquistato un prodotto di qualità disegnato e costruito per esservi d'aiuto per lungo tempo purché utilizzato e mantenuto secondo le presenti istruzioni. Potrebbero essere riscontrate delle variazioni tecniche sull'apparecchiatura, introdotte senza preavviso, nello sforzo continuo di migliorarlo ulteriormente.

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

## 1.1 COSTRUTTORE

CHINESPORT S.p.A. Via Croazia n°2 33100 UDINE - ITALIA  
TEL. 0432 522315 FAX 0432 521792

## 1.2 SCOPO E CONTENUTO DELLE ISTRUZIONI

**Il Cliente deve leggere attentamente le informazioni riportate nel presente libretto.**

Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo dell'apparechiatura, sia in grado di gestire la stessa in autonomia e sicurezza. Esso contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto in oggetto è rivolto agli utenti (medico - terapeuta) ed ai Tecnici abilitati alla manutenzione dell'apparechiatura, deve sempre seguire l'apparechiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

## 2. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

## 2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il RIABILITATORE ARTI CHINESPORT è uno strumento che, usato sotto il controllo di un medico - terapeuta, permette di effettuare esercizi di riabilitazione e potenziamento degli arti superiori ed inferiori. I pianele imbottiti sono rivestiti in similpelle lavabile.

La struttura è costituita da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e le parti scorrevoli in acciaio cromato.

## 2.2 CONDIZIONI AMBIENTALI ED IMMAGAZZINAGGIO

L'apparechiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperatura ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%.

In caso di immagazzinaggio si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali

- umidità relativa:	10%	-	90 %
- temperatura:	-10 °C	-	+50 °C

## 3. SICUREZZA

## 3.1 AVVERTENZE GENERALI

L'utente deve leggere con attenzione le informazioni riportate nel presente Manuale, in particolare le precauzioni per la sicurezza elencate in questo capitolo.

## 3.2 USO PREVISTO

L'apparechiatura è stata concepita e costruita esclusivamente per eseguire le funzioni descritte su questo Libretto istruzioni.

L'apparechiatura non deve essere utilizzata:


- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- Senza la supervisione di un terapeuta
- Senza la prescrizione di uno specialista
- Esposta alle intemperie.

## 3.3 AVVERTENZE PARTICOLARI

- **Tenersi ad adeguata distanza dalle parti in meccaniche in movimento durante lo svolgimento della terapia.**
- **Regolazioni e tarature vanno eseguite a macchina ferma.**
- **Serrare bene tutti i volantini prima dell'uso.**
- **Trasportare l'apparechiatura sempre in due persone afferrando le gambe.**
- **La similpelle di rivestimento non resiste a temperature superiori a 50°C.**
- **Non sedersi sullo schienale**
- **L'asse di rotazione del braccio oscillante deve essere in linea con quello dell'arto in trattamento durante l'uso.**

## 4. MESSA IN FUNZIONE

## 4.1. PRINCIPALI COMPONENTI

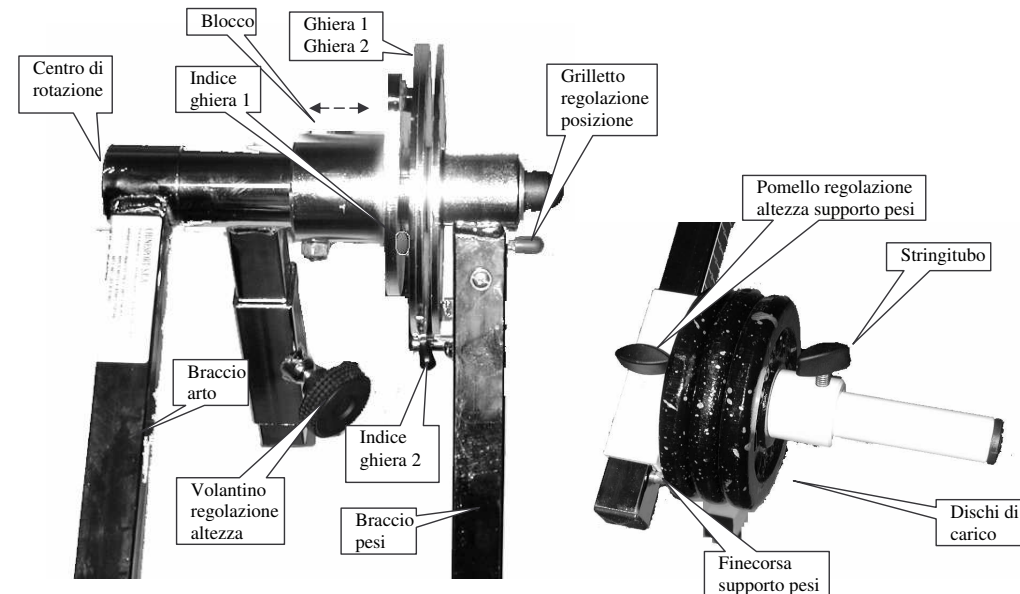

## 4.2 PREDISPOSIZIONE ED UTILIZZO

Eseguire le operazioni nel seguente ordine:

1. Estrarre l'apparechiatura, le dotazioni dall'imballo e trasferirle nel luogo d'uso.
2. Assicurarsi che l'apparechiatura sia in situazione di buona stabilità.
3. Infilare il **braccio oscillante** nell'apposita predisposizione laterale Dx o Sx a seconda dell'arto da trattare. Serrare quindi il **volantino regolazione altezza** (per un corretto utilizzo dell'apparechiatura il **centro di rotazione** del **braccio arto** deve corrispondere con quello dell'arto da trattare).
4. Regolare la posizione dello schienale nella posizione desiderata agendo sulla leva di blocco della molla a gas di regolazione posta nel retro della sedia; con lo schienale totalmente reclinato è possibile eseguire esercizi in posizione prona.
5. Regolare il posizionamento e l'angolazione del braccio oscillante in funzione dell'esercizio e delle prescrizioni del medico - terapeuta:
  - a) Tirare il **blocco** verso il **braccio arto**.
  - b) Regolare l'angolazione di "andata" ruotando la **ghiera 1** fino al punto desiderato e spingere il blocco verso la ghiera di una posizione.
  - c) Regolare l'angolazione di "ritorno" ruotando la **ghiera 2** fino al punto desiderato e spingere il blocco verso la ghiera fino a finecorsa.
  - d) Se del caso regolare la posizione del **braccio pesi** svincolandolo dal **braccio arto** tramite il **grilletto di regolazione posizione**
6. Applicare gli appositi **dischi di carico**, in funzione dell'esercizio e delle prescrizioni del medico - terapeuta, al **braccio pesi** e assicurarli con lo **stringitubo** (i **dischi peso in eccesso** possono essere posizionati negli appositi portapesi situati sulle gambe posteriori dell'apparechiatura).
7. Vincolare le cosce alla seduta abbassando con l'apposito fermacosce e l'arto al **braccio arto** con l'apposita cinghia.
8. Eseguire il trattamento.